


แนวทางปฏิบัติ


การจัดบริการศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตสุขภาพ



อ้างอิง หนังสือ ที่ สธ 0207.11/11393 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ

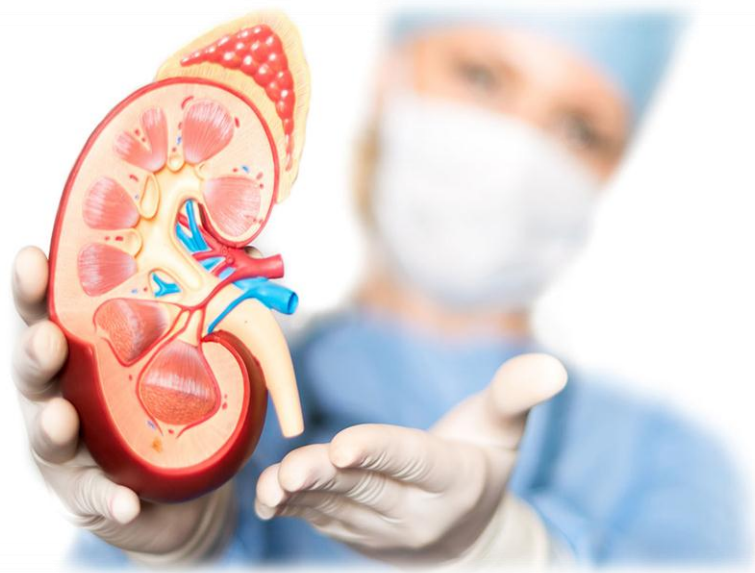

อ้างอิง หนังสือ ที่ สธ 0207.11/11393 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1. การเปิดหน่วยฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมแห่งใหม่

1.1 ระดับโรงพยาบาล

ระดับโรงพยาบาล
ควรอยู่ใน
โรงพยาบาลระดับ
A, S และ M1 หรือ
ตามความเห็นของ
คณะกรรมการ

1.2 การทำงานร่วมกันเป็นรูปแบบเครือข่ายระดับเขต

- มีคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติการขอ
เปิดหน่วยฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไปเทียม
ระดับเขต
- มีการประชุมนำเสนอ
ข้อมูลประกอบการขอ
เปิดหน่วยฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไปเทียมแห่ง
ใหม่ตั้งแต่ก่อนเริ่ม
ดำเนินการก่อสร้างแก่
คณะกรรมการ

1.3 การบริการสามารถดำเนินการได้ 4 รูปแบบ

- (1) โรงพยาบาลจัดซื้ออุปกรณ์มาดำเนินการให้ส่วนฟอก
เลือดด้วยเครื่องไปเทียมในโรงพยาบาล
- (2) โรงพยาบาลเช่าอุปกรณ์มาดำเนินการให้บริการ
ศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไปเทียมในโรงพยาบาล
- (3) โรงพยาบาลจ้างเหมาบริการเอกชนมาดำเนินการ
ให้บริการศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไปเทียมในโรงพยาบาล
(โดยในรูปแบบ (1)-(3) โรงพยาบาลจําดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
- (4) โรงพยาบาลให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุน(PPP)ในการ
จัดบริการศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไปเทียมในโรงพยาบาล
(โรงพยาบาลจําดำเนินการตามพระราชบัญญัติการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556)

1.4 แนวทางการบริหารจัดการยา

ยา Erythropoiesis
stimulating agents
(ESA) ต้องจัดซื้อผ่าน
โรงพยาบาลตาม
ระเบียบพัสดุฯ
ยกเว้นยาที่ได้รับจาก
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

1.2 การทำงานร่วมกันเป็นรูปแบบเครือข่ายระดับเขต

คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียม เขตสุขภาพที่ 8



คำสั่งคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๘
ที่ ๑๑๒ / ๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เขตสุขภาพที่ ๘

อาศัยอำนาจตามข้อ ๔.๗ ของคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๑๖/๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเขตสุขภาพที่ ๑ - ๑๒ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙

คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๘ จึงออกคำสั่งไว้ดังต่อไปนี้

ให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เขตสุขภาพที่ ๘ มีองค์ประกอบ ดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------------|
| ๑.๑ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี | ประธานกรรมการ |
| ๑.๒ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ เขตสุขภาพที่ ๘ (CSO) | รองประธานคนที่ ๑ |
| ๑.๓ นายพิสิฐ อินทรวงษ์ อดีตนายแพทย์เชี่ยวชาญ ประธานสาขาไต เขตสุขภาพที่ ๘ | รองประธานคนที่ ๒ |
| ๑.๔ นางสาวปัทมาพร คำใจ | |

บทบาทหน้าที่

๑. พิจารณาข้อมูลประกอบการขอเปิดศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมใหม่ของหน่วยบริการที่แสดงความจำนงขอเปิดศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมใหม่ ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดที่คณะกรรมการนั้นรับผิดชอบ
๒. พิจารณาอนุมัติการขอเปิดศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมใหม่ ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดที่คณะกรรมการนั้นรับผิดชอบ
๓. ให้คำแนะนำแก่ผู้รับผิดชอบของงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๘ ในการพิจารณาอนุมัติการขอเปิดศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมใหม่ ในสถานพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
๔. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินการ
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายชาญวิทย์ ทระเทพ)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๘
ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๘

คณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.)

2. การกำกับมาตรฐานหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม


2.1 มาตรฐาน

- ➔ ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากอนุกรรมการ ทรต.
- ➔ มีเครือข่ายแพทย์และบุคลากรให้บริการและการกำหนดคุณสมบัติของแพทย์ผู้รับผิดชอบผู้ป่วยและหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในโรงพยาบาลระดับต่างๆ กำหนดให้มีบุคลากรตามมาตรฐานของอนุกรรมการ ทรต.
- ➔ ต้องมีแพทย์หัวหน้าหน่วยไตเทียม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการหน่วยไตเทียม
- ➔ กำหนดให้มีแพทย์รับผิดชอบตรวจเยี่ยมผู้ป่วยฟอกเลือดตามมาตรฐานอนุกรรมการ ทรต. ให้เหมาะสมกับภาระงาน
- ➔ อย่างน้อยต้องมีแพทย์ปฏิบัติทั่วไปอยู่ในโรงพยาบาลขณะกำลังให้บริการฟอกเลือด
- ➔ ต้องมีระบบการปรึกษาหรือส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินร่วมกับอายุรแพทย์โรคไตหรือกุมารแพทย์โรคไตผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดที่ตั้งของหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ยกเว้นจังหวัดที่ไม่มีอายุรแพทย์โรคไตหรือกุมารแพทย์โรคไต ให้อายุรแพทย์โรคไตหรือกุมารแพทย์โรคไตในจังหวัดที่ติดกันในเขตเดียวกันเป็นผู้รับปรึกษาหรือรับส่งต่อกรณีฉุกเฉิน)

2. การกำกับมาตรฐานหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติและแนวทางการกำกับดูแล (แห่งที่เปิดใหม่)

รูปที่ ๑. แนวทางการตรวจและรับรองหน่วยไตเทียมใหม่ที่ยังไม่เคยรับการประเมินมาก่อน

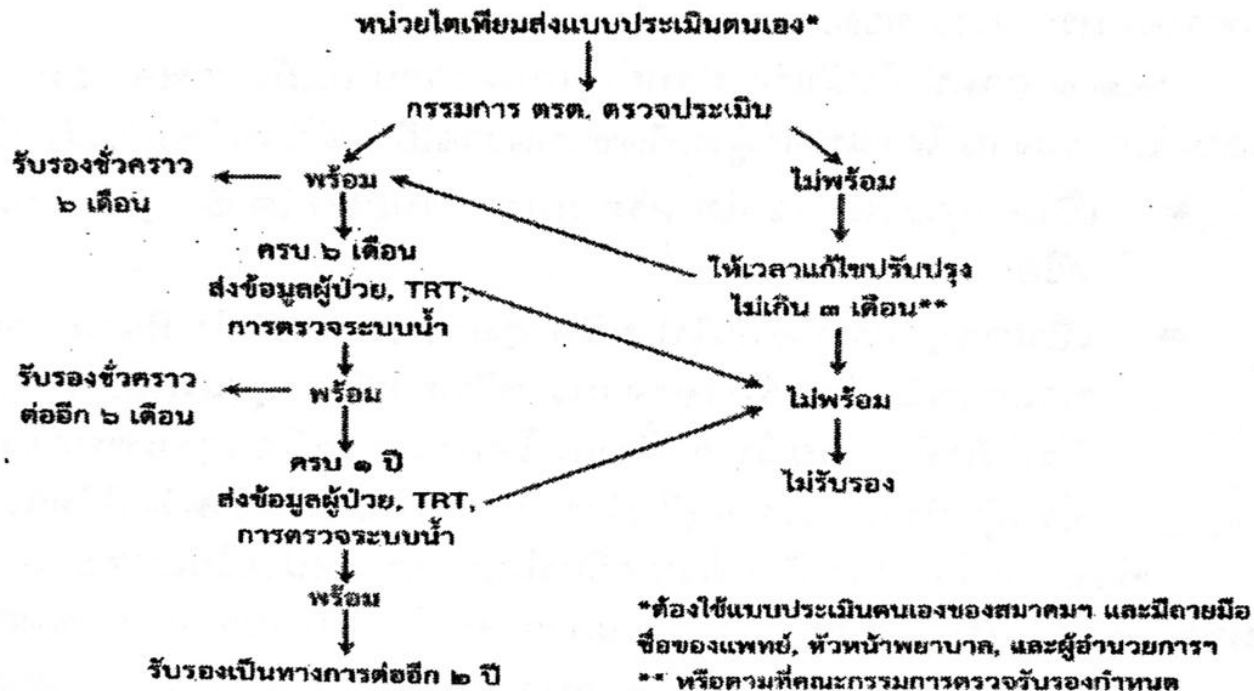

Epiao

Eporon


Renogen

Hema-plus

Espogen

Hypercrit

Epokine





แนวทางการบริหารจัดการ



เสนอแนะให้มีการซื้อร่วม

ยา Erythropoiesis stimulating agents (ESA)
ทั้งเขต

ขอบคุณ